



Instrumentos y accesorios

para cirugía de hidrocirugía




Advertencias importantes

La compañía limitada Erbe Elektromedizin GmbH ha puesto el máximo cuidado al compilar este catálogo de accesorios de electrocirugía. A pesar de ello, no se pueden excluir errores.

Las informaciones y recomendaciones contenidas en el catálogo no justifican exigencias contra la compañía limitada Erbe Elektromedizin GmbH. Si, a pesar de ello, resultara una responsabilidad legítima por determinaciones imperativas, ésta se limitará a premeditación y negligencia grave.

Los datos sobre el uso del instrumental se basan en experiencias clínicas. Como consecuencia de la investigación y de las experiencias clínicas, la tecnología y el diseño de nuestros productos se encuentran en permanente evolución.

Otras informaciones sobre el producto

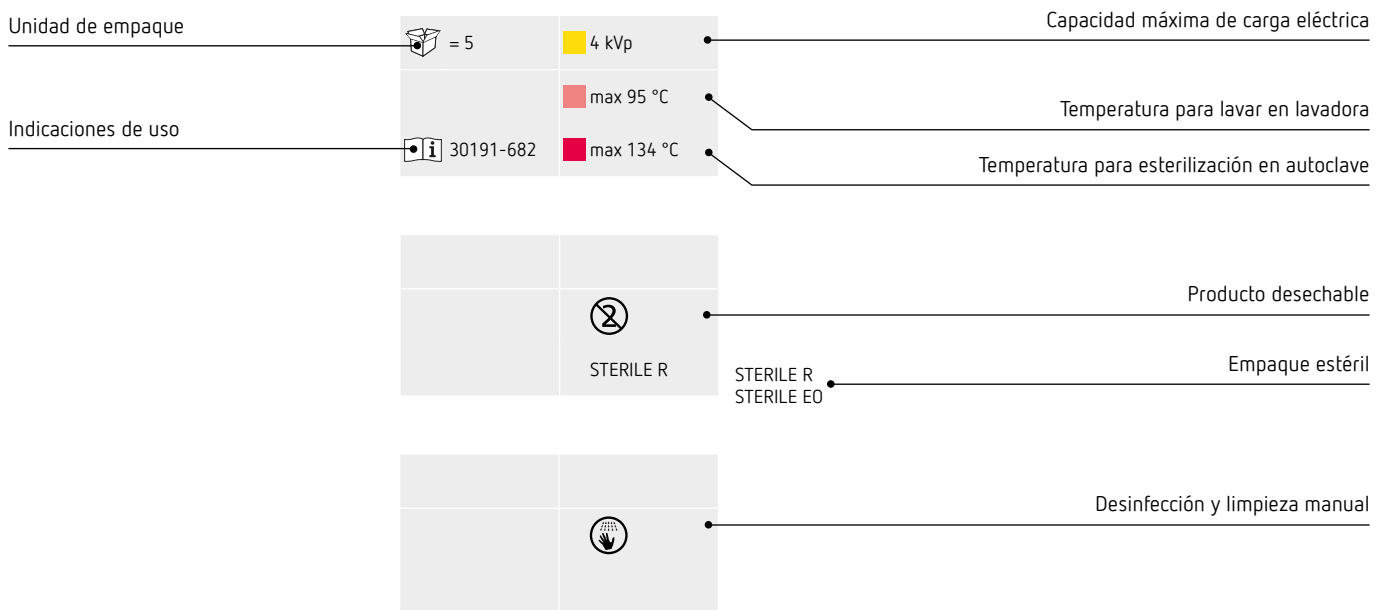

Antes del uso, rogamos siempre leer las indicaciones de uso correspondientes.

Hidrocirugía

Instrumentos y accesorios

- 04 Instrumentos híbridos
- 06 Aplicadores y sondas
- 08 Accesorios para ERBEJET 2
- 09 Accesorios para ESM 2
- 11 Carros de aparatos y accesorios

Instrumentos y accesorios

Instrumentos híbridos

HybridKnife, tipo T, chorro pleno, \varnothing 2,3 mm, longitud 1,9 m

con clavija de conexión Internacional (3-Pin)



No. 20150-060

= 5

2.5 kVp

30150-116



STERILE EO

HybridKnife, tipo I, chorro pleno, \varnothing 2,3 mm, longitud 1,9 m

con clavija de conexión Internacional (3-Pin)



No. 20150-061

= 5

2.5 kVp

30150-116



STERILE EO

HybridKnife, tipo O, chorro pleno, \varnothing 2,3 mm, longitud 1,9 m

con clavija de conexión Internacional (3-Pin)



No. 20150-062

= 5

0.99 kVp

30150-116




STERILE EO

Instrumentos y accesorios

Instrumentos híbridos

HYBRIDknife flex I-Type, electrodo 1,5 mm, \varnothing 2,6 mm, longitud 2,3 m

con clavija de conexión Internacional (3-Pin)



No. 20150-112

= 5

4.5 kVp

30150-169



STERILE EO

HYBRIDknife flex I-Type, electrodo 2,0 mm, \varnothing 2,6 mm, longitud 2,3 m

con clavija de conexión Internacional (3-Pin)



No. 20150-113

= 5

4.5 kVp

30150-169



STERILE EO

HybridAPC, \varnothing 2,3 mm, longitud 1,9 m



No. 20150-015

= 5

4.3 kVp

30150-147



STERILE EO

Aplicador, recto, monopolar, \varnothing 6 mm, longitud 80 mm

con aspiración, p.ej. para cirugía hepática



No. 20150-036

= 5

2.5 kVp

30150-205



STERILE EO

Instrumentos y accesorios

Aplicadores y sondas

Aplicador, punta curva, ø 5 mm, longitud 183 mm

p.ej. para la urología



No. 20150-025

= 5

30150-000



STERILE EO

Aplicador, punta curva, ø 5 mm, longitud 336 mm

p.ej. para la laparoscopia



No. 20150-026

= 5

30150-000



STERILE EO

Aplicador, recto, ø 6 mm, longitud 65 mm

con aspiración, p.ej. para cirugía hepática



No. 20150-030

= 5

30150-000



STERILE EO

Aplicador, punta flexible, ø 6 mm, longitud 65 mm

con aspiración, p.ej. para cirugía hepática



No. 20150-031

= 5

30150-000



STERILE EO

Aplicador, recto, ø 6 mm, longitud 306 mm

con aspiración, p.ej. para escisión mesorrectal total (TME)



No. 20150-038

= 5

30150-000



STERILE EO

Instrumentos y accesorios

Aplicadores y sondas


Aplicador, recto, \varnothing 6 mm, longitud 180 mm

con aspiración, p.ej. para microcirugía endoscópica transanal (TEM)



No. 20150-039

 = 5

 30150-000



STERILE EO


Aplicador, bayoneta, \varnothing 2,8 mm, longitud 90 mm

con aspiración



No. 20150-041

 = 5

 30150-000



STERILE EO


Sonda flexible, \varnothing 1,3 mm, longitud 2,2 m

p.ej. para la endoscopia flexible



No. 20150-020

 = 5

 30150-000



STERILE EO

Instrumentos y accesorios

Accesorios para ERBEJET 2

Unidad de bomba plus para ERBEJET 2



No. 20150-301

= 5

30150-400



STERILE EO

Interruptor monopedal ERBEJET 2 ReMode con ReMode, con AP & IP X8



No. 20150-101

= 1

30150-100

max 75 °C



Interruptor de 2 pedales ERBEJET 2 ReMode con ReMode, con AP & IP X8



No. 20150-100

= 1

30150-100

max 75 °C



Otros accesorios para interruptores de pedal

	Pieza	No.
Estribo de protección para interruptor de 2 pedales VIO	1	20189-306
Cable para interruptor de pedal ERBEJET 2	1	20150-104

Cables de red	País	Longitud	Pieza	No.
Cable de red 10A	Alemania	0,5 m	1	51704-046
Cable de red 10A	Alemania	2,5 m	1	51704-037
Cable de red 10A	Alemania	4 m	1	51704-032
Cable de red 10A	Alemania	5 m	1	51704-042
Cable de red 10A	Gran Bretaña	2,5 m	1	51704-038
Cable de red 10A	Gran Bretaña	5 m	1	51704-043
Cable de red 10A	Italia	2,5 m	1	51704-040
Cable de red 10A	Italia	5 m	1	51704-045
Cable de red 10A	Canadá	4 m	1	51704-039
Cable de red 10A	India	4 m	1	20128-004

Instrumentos y accesorios

Accesorios para ESM 2

Recipiente de la aspiración, 1,5 litros

para uso con bolsa de aspiración 20340-012



No. 20340-102

= 1

Bolsa de aspiración, 1,5 litros

para uso con recipiente de la aspiración 20340-102



No. 20340-012

= 30



Bolsa de aspiración, 2,5 litros

para uso con recipiente de la aspiración 20340-103



No. 20340-013

= 30



Instrumentos y accesorios

Accesorios para ESM 2

Filtro de membrana para ESM



para uso con tubo de silicona 20340-004

No. 20340-100

 = 10





Tubo de silicona, longitud 600 mm



No. 20340-004

 = 1

 max 95 °C

 max 134 °C

Soporte del carril



para uso con recipiente para aspiración 20340-102 y 20340-103

No. 20340-002


 = 1


Válvula commutadora, soporte del carril y 2 tubos de silicona, longitud 300 mm



No. 20340-003

 = 1

 max 95 °C

 max 134 °C

Cable de conexión

Cable de conexión ECB para ERBEJET 2, longitud 0,45 m

No.

51709-008

Juego de elementos de fijación

Juego de elementos de fijación EIP 2 / ESM 2 en VIO CART 20180-000

No.

20180-135

Instrumentos y accesorios

Carros de aparatos y accesorios

VIO CART, soporte de sistema para los equipos VIO y sus módulos



Dimensiones: 630 x 940 x 650 mm (An x Al x P)
 Peso: 31 kg
 4 ruedas giratorias conducidas \varnothing 100 mm con frenos de fijación
 1 entrada de red
 3 salidas de red

Incluye los siguientes accesorios:
 1 asidero de acero inoxidable
 2 soportes para cables
 1 soporte para los interruptores de pedal VIO
 (actualmente disponibles)

No. 20180-000

= 1

80180-018



Gancho para bolsa de irrigación en el soporte / VIO CART



No. 20325-002

= 1

max 95 °C

max 134 °C

Soporte para VIO CART, superior, longitud 260 mm




No. 20180-040

= 1



Soporte para VIO CART, inferior, longitud 390 mm

para el uso de la aspiración de secreción



No. 20180-042

= 1



Juegos de elementos de fijación

Juego de elementos de fijación VIO D/S / APC 2 / ERBEJET 2 en VIO CART 20180-000

20180-131

Juego de elementos de fijación EIP 2 / ESM 2 en VIO CART 20180-000

20180-135

Juego de elementos de fijación en ERBEJET 2, conexión de VIO / APC 2

20150-050

Important information

The information, recommendations and other details contained in this medium ("information") reflect our state of knowledge and the state of the art in science and technology at the time the medium was created. The information is of a general nature, non-binding and intended solely for general information purposes; it does not constitute instructions for use.

The information and recommendations contained in this medium do not create any legal obligations on the part of Erbe Elektromedizin GmbH and its affiliated companies ("Erbe") or any other claims against Erbe. The information does not constitute any guarantees or other information on the nature of the product; such information requires an express contractual agreement with Erbe in each individual case.

Erbe is not liable for any kind of damage resulting from following the information on this medium, regardless of any legal grounds for liability.

Every user of an Erbe product is responsible for testing the respective Erbe product in advance with regard to its properties and its suitability for the intended type of use or purpose. Suitable type of use of the respective Erbe product can be found in the instructions for use for the respective Erbe product. The user is obliged to ascertain whether the instructions for use available to him/her correspond to the current status of the specific Erbe product. Devices may only be used in accordance with the instructions for use.

Information on settings, application sites, application duration and use of the respective Erbe product is based on the clinical experience of individual centers, physicians and clinical literature independent of Erbe as well as post market surveillance and empirical evidence. They constitute reference values, or Experienced Starting Settings, which must be checked by the user to ensure that they are suitable for the specifically planned application. Depending on the circumstances of a specific application, it may be necessary to deviate from the information provided. The user is responsible for checking this when using Erbe products. We wish to note that science and technology are subject to constant development as a result of research and clinical experience. Similarly, medicine and clinical application are constantly evolving as a result of research and technological development. This may also make it necessary for the user to deviate from the information provided on this medium.

This medium contains information about Erbe products that may not be approved/cleared in certain countries. The user of the respective Erbe product is obliged to inform himself/herself as to whether the Erbe product he/she is using is legally approved/cleared in his/her country and/or to what extent, if any, there are legal requirements for or restrictions on its use.

This medium is not intended for use in the USA.

Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Alemania

Tel +49 7071 755-0
info@erbe-med.com
erbe-med.com
medical-videos.com